

INDICATIONS

Accouchement imminent, en cours ou réalisé.

PRESENTATION

Le kit accouchement se compose de :

- 1 set accouchement
- 2 clamps de Bar
- 1 bonnet
- 1 sonde d'aspiration pédiatrique
- 1 stop vide pédiatrique
- 1 insufflateur à usage unique « nouveau-né et nourrisson » (< 10 kg)
- Sacs DASRI
- 2 couvertures de survie
- 3 fiches papier :
 - Bilan de la parturiente (femme enceinte)
 - Fiche de liaison avec la salle d'accouchement
 - Prise en charge du nouveau-né à la naissance

Le tout rangé dans un sac zip



Lors d'un accouchement, ce kit sera complété par :

- 1 bouteille d'O2 supplémentaire (en plus de celle du sac de prompt secours, 1 pour la mère et 1 pour l'enfant)
- L'aspirateur à mucosités



REALISATION

L'utilisation des éléments du kit accouchement sera à adapter selon que l'accouchement soit imminent, en cours ou déjà réalisé (utilisation uniquement des clamps de Bar et du bonnet par exemple)

Installation de la victime

Sur un lit ou dans un lieu adapté

Si l'accouchement risque d'avoir lieu dans le VSAV :

- Installer le brancard tête coté porte arrière pour avoir de l'espace pour travailler.
- Augmenter le chauffage pour avoir une température entre 25 et 30°C

Demander à la parturiente de quitter ses vêtements



Se nettoyer les mains, mettre des gants d'examen et ouvrir le set accouchement




1




2

Ouvrir le set accouchement

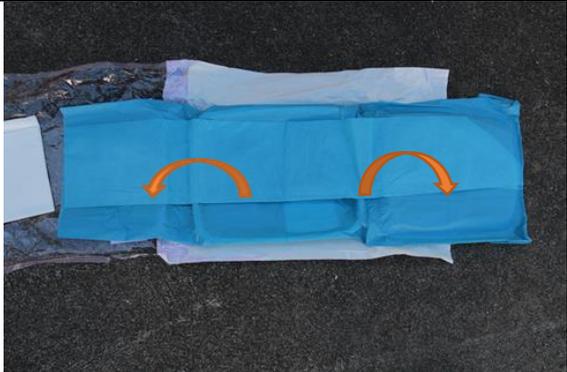

3

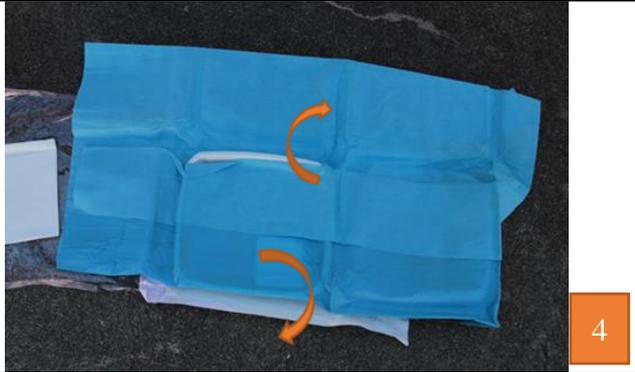

4

Déplier le champs stérile



5

Penser à sortir:


- les clamps de Bar
- le BAVU
- le bonnet

Champ sous fessier avec poche de recueil des liquides

Champ stérile

Ciseau* ouvert

Plateau (pouvant servir au recueil du placenta)

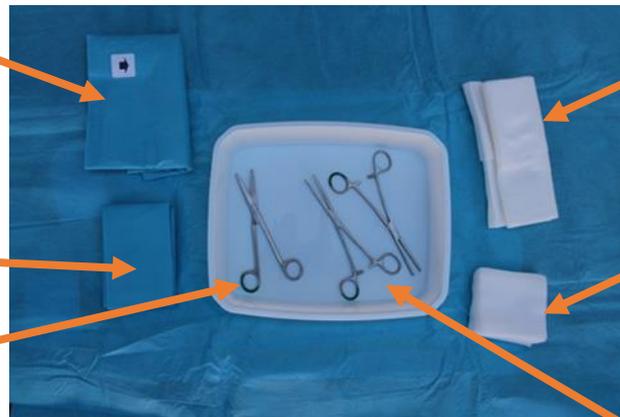

Champ de recueil nouveau-né

Compresse

6

Pinces Kocher* ouvertes

*Pourront être utilisé pour sectionner le cordon ombilical ou en cas de circulaire du cordon (sur guidance et indication médicale)

Installer le champ sous fessier



Déplier le champ sous fessier





Insérer vos mains dans les ouvertures du champ

Glisser le champ sous les fesses de la parturiente



Positionner le champ et la parturiente suffisamment au bord du brancard ou du lit... pour que la poche de recueil se trouve dans le « vide ».

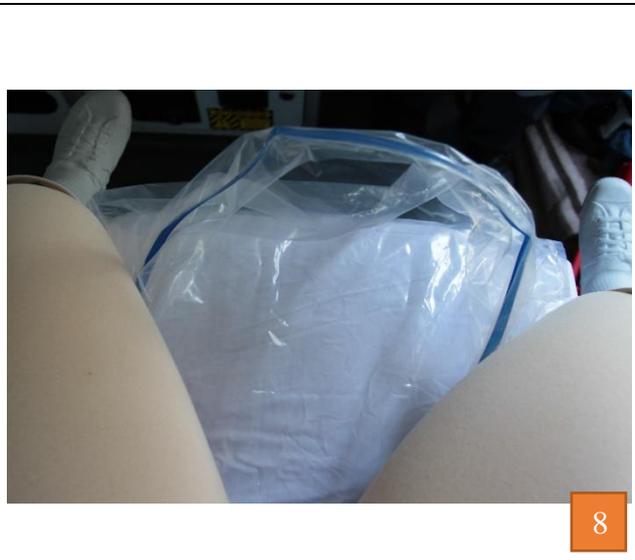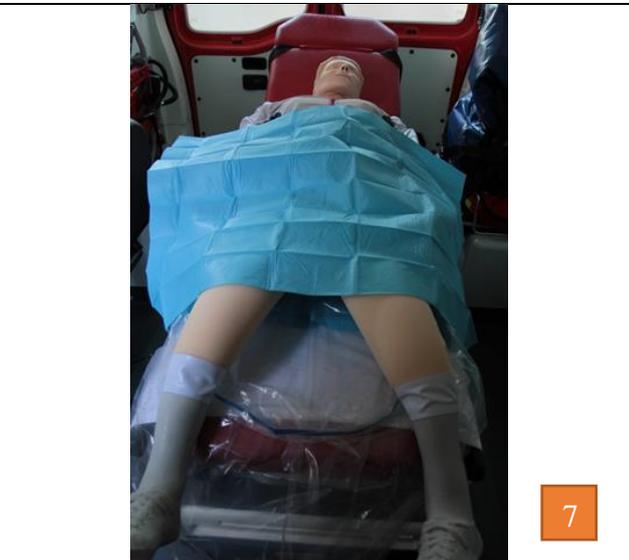

Couvrir la parturiente et ouvrir la poche de recueil.



Une fois l'accouchement réalisé, noter le niveau de liquide (amniotique).

Par la suite vous pouvez suivre les pertes sanguines sur la poche de recueil graduée (niveau d'alerte = 500ml).

Si la délivrance a lieu, conserver le placenta dans le plateau.

Prise en charge du nouveau-né



Sécher **rapidement** le nouveau-né dans le champ de recueil, en frictionnant le dos.



Sortir le bonnet de son emballage



Mettre un bonnet au bébé



Enlever le champ de recueil
Déposer le nouveau-né en peau à peau (visage sur le côté) et envelopper la maman et l'enfant avec la couverture de survie

Clamper le cordon ombilical :

- 1^{er} clamp de Bar à 10 cm de l'ombilic du bébé
- 2^{ème} clamp de Bar à 15 cm de l'ombilic du bébé.

En l'absence de geste de réanimation le cordon ne sera pas coupé sans avis médical

5



Si des gestes de secourisme sont nécessaires, sur la mère ou le nouveau-né, sectionner le cordon ombilical et envelopper dès que possible le nouveau-né dans une couverture de survie.

ENTRETIEN/MAINTENANCE

- Déchets souillés (compresse, plateau, BAVU, sonde d'aspiration...) seront jetés dans un sac DASRI
- Contrôler les dates de péremption et l'intégrité des emballages.
 - o Ne pas tenir compte de la date de péremption du bonnet

REASSORT

Les éléments du kit accouchement utilisés seront commandés à la PUI sur le bon de commande des VSAV.
Les clamps de Bar des lots de secours, seront commandés à la PUI sur le bon de commande des CIS sans VSAV.