
FICHE REFLEXE
ECG 12D à l'aide du DEFIGARD TOUCH SEVEN SCHILLER




1/ Positionnement des brins - électrodes périphériques (4 brins)

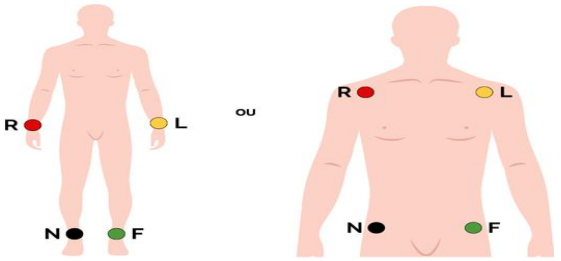


- Électrode **rouge**, **R ou RA (Right Arm)**: face interne de l'avant-bras droit ou au niveau du poignet ou épaule droite
- Électrode **jaune**, **L ou LA (Left Arm)**: face interne de l'avant-bras gauche ou au niveau du poignet ou épaule gauche
- Électrode **noire**, **N ou RL (Right Leg)** : au-dessus de la cheville droite (masse neutre) ou crête illiaque droite. **Cette électrode de mise à la terre**, aussi appelée **électrode neutre** est utilisée dans un ECG pour **stabiliser le signal électrique** et **réduire les interférences électriques**.
- Électrode **verte**, **F ou LL (Left Leg)** : au-dessus de la cheville gauche ou crête iliaque gauche

2/ Positionnement des brins - électrodes précordiales (thoraciques - 6 brins)

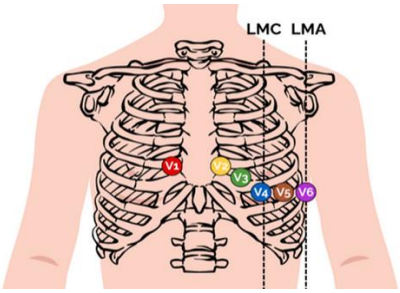

- **V1** : 4e espace intercostal, **bord droit du sternum**
- **V2** : 4e espace intercostal, **bord gauche du sternum**
- **V3** : entre V2 et V4
- **V4** : 5e espace intercostal, **ligne médio-claviculaire gauche (LMC)**
- **V5** : même niveau horizontal que V4, entre V4 et V6
- **V6** : même niveau horizontal que V4, **ligne médio-axillaire (LMA)**


3/ Acquisition de l'ECG

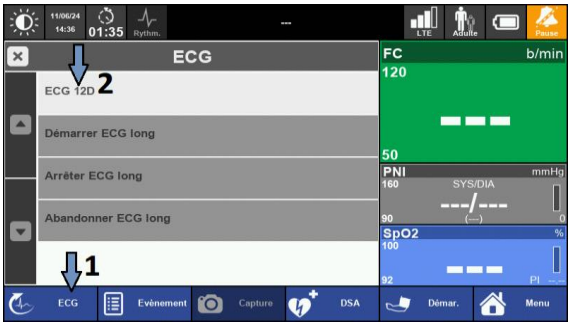

1 : Cliquer en bas à gauche sur la case "ECG"


2 : Sélectionner ECG 12D et cliquer sur "Suivant"

4/ Vérification des électrodes

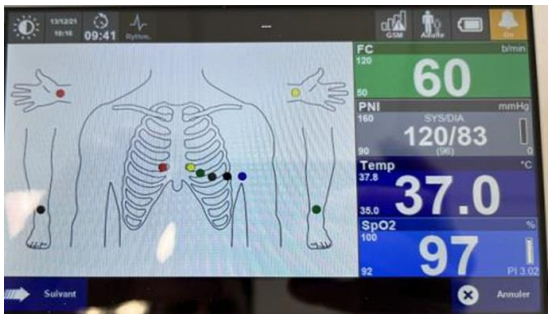


Les pastilles de couleur ci-dessus avec un cercle rouge clignotant sont les connectiques à vérifier (électrode défaillant ou brin non connecté)

5/ Renseignement des "informations patient"

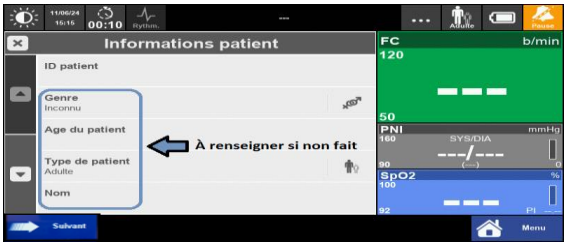


Renseigner les élements entourés de bleu.

Cliquer sur 

après avoir dit à la victime de respirer normalement, sans bouger ni parler.

Une fois l'ECG réalisé, l'envoi est automatique. En cas d'échec, envoi manuel à partir du menu de l'appareil.

6/ Envoi de l'ECG via le BPV (à privilégier)

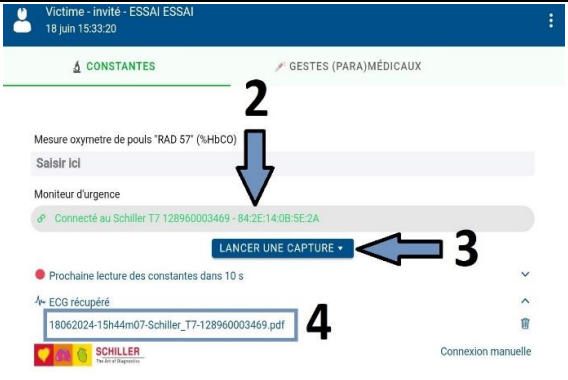

1 : Aller dans la catégorie :
Constantes et gestes pratiqués

2 : Activer bluetooth sur le SCHILLER T7. L'écriture verte indique une connection fonctionnelle

3 : Cliquer sur "Lancer une capture" puis sur "Récupérer dernier ECG"

4 : Une fois l'ECG réalisé, il apparait comme dans la case.

Attention : Il est parfois nécessaire de quitter le BPV puis d'y retourner pour que cela fonctionne.